



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลกลาง (โทร. ๐ ๒๒๒๐ ๘๐๐๐ ต่อ ๒๒๒๑๔ โทรสาร ๐ ๒๒๒๕ ๑๘๓๐)

ที่ วันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อออกซิเจนเหลว จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ต้นเรื่อง

๑. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลางปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นชอบให้ดำเนินการจัดซื้อออกซิเจนเหลว จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ระยะเวลา ๑๐ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ภายในวงเงิน ๒,๗๐๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๖๑ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ รายการค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๘ (๓) และอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามหนังสือลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๒. โรงพยาบาลกลางมีหนังสือลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เชิญบริษัท แอร์โปรดักส์ อินดัสตรีย์ จำกัด เพื่อเข้ามายื่นเสนอเอกสารเสนอราคา จัดซื้อออกซิเจนเหลว จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และคณะกรรมการซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และทำการพิจารณาเอกสารในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป นั้น ณ ห้องเปิดซอง ฝ่ายพัสดุ ชั้น ๒ อาคารเอื้อประชา โรงพยาบาลกลาง

ข้อเท็จจริง

๑. วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ บริษัท แอร์โปรดักส์อินดัสตรีย์ จำกัด ยื่นของเสนอราคา จัดซื้อออกซิเจนเหลว จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร

๒. คณะกรรมการซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๕๕ (๔) โดยอนุโลม และข้อ ๗๔ เรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๒.๑ ตรวจสอบรายละเอียดการจัดซื้อออกซิเจนเหลว จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ ของบริษัท แอร์โปรดักส์อินดัสตรีย์ จำกัด แล้วผลปรากฏว่า ได้เสนอรายละเอียด พร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาและตรวจสอบรายละเอียดแล้วเห็นว่า เอกสารหลักฐานต่างๆ ครบถ้วน ถูกต้อง ประกอบกับเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง

๒.๒ เปิดซองใบเสนอราคา ของบริษัท แอร์โปรดักส์อินดัสตรีย์ จำกัด ผลปรากฏว่าเสนอราคาออกซิเจนเหลวจำนวน จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ราคาลูกบาศก์เมตร ๘.๘๐ บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๖๔๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านหกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ราคาสินค้า ๒,๔๖๗,๒๘๙.๗๒ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๑๗๒,๗๑๐.๒๘ บาท คณะกรรมการฯ จึงได้ทำการต่อรองราคา ซึ่งทางบริษัทฯ ขอยืนยันราคาเดิม เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๖๔๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านหกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ราคาสินค้า ๒,๔๖๗,๒๘๙.๗๒ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๑๗๒,๗๑๐.๒๘ บาท รายละเอียดตามใบต่อรองราคาลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ตามถูกต้อง

A. Natch

๓. คณะกรรมการ...

นายพนนทพันธ์ เอกสกุลชัย

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

โรงพยาบาลกลาง

๓. คณะกรรมการซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พิจารณาแล้วเห็นว่าราคาที่ต่อรอง เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๖๔๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านหกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) เป็นราคาที่เหมาะสมไม่เกินวงเงินที่ขอเห็นชอบไว้ ๒,๗๐๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ประกอบกับเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการให้บริการแก่ผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษา จึงเห็นควรอนุมัติจัดซื้อออกซิเจนเหลว จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ราคาลูกบาศก์เมตร ๘.๘๐ บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๖๔๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านหกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ราคาสินค้า ๒,๔๖๗,๒๘๙.๗๒ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๑๗๒,๗๑๐.๒๘ บาท ระยะเวลา ๑๐ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ จากบริษัท แอร์โปรดักส์อินดัสตรี จำกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อพิจารณาและเสนอแนะ ฝ่ายพัสดุพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การจัดซื้อออกซิเจนเหลว จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรพิจารณา ดังนี้

๑. อนุมัติจัดซื้อออกซิเจนเหลว จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ราคาลูกบาศก์เมตร ๘.๘๐ บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๖๔๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านหกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ราคาสินค้า ๒,๔๖๗,๒๘๙.๗๒ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๑๗๒,๗๑๐.๒๘ บาท จากบริษัท แอร์โปรดักส์อินดัสตรี จำกัด กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ๑๐ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๖๑ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ รายการค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๘ (๓)

๒. อนุมัติให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒

๓. อนุมัติให้เรียกเก็บหลักประกันสัญญาจากผู้รับจ้างเป็นจำนวนเต็มในอัตราร้อยละห้าของราคาจะซื้อจะขาย เป็นเงิน ๑๓๒,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๗ และข้อ ๑๖๘

๔. อนุมัติให้ทำสัญญาจะซื้อจะขายได้เมื่อนิติกรสำนักงานการแพทย์ได้ตรวจร่างสัญญา และโรงพยาบาลกลางได้รับอนุมัติเงินประจำงวดสำหรับจัดซื้อออกซิเจนเหลวประจำปี ๒๕๖๑ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ รายการค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุเคมี เรียบร้อยแล้ว

๕. อนุมัติเบิกจ่ายเงินได้เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุไว้ครบถ้วนถูกต้องตามใบสั่งซื้อในแต่ละงวด

๖. โปรดลงนามเอกสารที่แนบ

อำนาจอนุมัติตามข้อ ๑-๔ และลงนามตามข้อ ๖ เป็นของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๕ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๘ (๓) ข้อ ๘๖ (๑) ข้อ ๑๖๒ ข้อ ๑๖๗ ข้อ ๑๖๘ โดยมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลางปฏิบัติราชการแทน ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ ๒๗๑๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด


ตามาถูกคือ

นายพันน์ เอกสกุลชัย
ผู้อำนวยการพัสดุปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลกลาง

จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐข้อ ๓ ในข้อ ๓.๓ (๓) อำนาจอนุมัติเบิกจ่ายเงินตามข้อ ๕ เป็นของผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลกลาง ตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ พ.ศ.๒๕๕๕ และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๓๓ (๒)


ร. เบนนทพันธ์ เอกสกุลชัย)
เจ้าหน้าที่งานพัสดุปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลกลาง

เรียน ผอ.รพก. (ผ่านรอง ผอ.รพก. ฝ่ายบริหาร)
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติตามข้อ ๑-๔
ลงนามตามข้อ ๖ ในฐานะปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อนุมัติเบิกจ่ายเงิน
ตามข้อ ๕ ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน


(นางสาวสุภาพร กรลักษ์)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากองพัสดุ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
๓๐ พ.ย. ๒๕๖๐


(นายธนากร สงวนสัตย์)
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง ฝ่ายบริหาร
๓๐ พ.ย. ๒๕๖๐ - อนุมัติ ข้อ ๑ - ๔
- ลงนาม ข้อ ๖


(นางสาวสุภาพร กรลักษ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
๓๐ พ.ย. ๒๕๖๐

- อนุมัติเบิกจ่ายเงินตามข้อ ๕


(นางสาวสุภาพร กรลักษ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง
๓๐ พ.ย. ๒๕๖๐

นางสาวสุภาพร กรลักษ์


ร. เบนนทพันธ์ เอกสกุลชัย)
เจ้าหน้าที่งานพัสดุปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลกลาง

สัญญาจะซื้อจะขายออกซิเจนเหลว จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร

สัญญาเลขที่ รพก.๕/๒๕๖๑

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ โรงพยาบาลกลาง สำนักงานแพทย์ กรุงเทพมหานคร แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐/ระหว่างกรุงเทพมหานคร โดย นางสาวสุภาพร กรลักษณ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร ตามคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ ๒๗๑๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้จะซื้อ” ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท แอร์โปรดักส์อินดัสตรี จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงาน ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๒๘๒ ถนนบางบอน ๓ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร โดยนางสาวรัตนันลิน พงศ์สิริภาวิน/ ผู้รับมอบอำนาจจาก นายสุวรรณ รุ่งเกียรติกุล และนายหัตถุยะ ชากาโมได้ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติ บุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร ที่ สจ.๑ ๐๓๕๑๒๓ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้จะขาย” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงจะซื้อจะขาย

ผู้จะซื้อตกลงจะซื้อ และผู้จะขายตกลงจะขาย ออกซิเจนเหลว จำนวนประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ราคาลูกบาศก์เมตรละ ๘.๘๐ บาท ผลผลิตภายในประเทศ ตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญานี้ ตามจำนวนที่ผู้จะซื้อจะสั่งซื้อเป็นคราวๆ ไป มีกำหนดเวลา ๑๐ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑/เป็นราคาทั้งสิ้นประมาณ ๒,๖๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ซึ่งรวม ภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ตลอดอายุสัญญานี้ผู้จะขายรับจะจัดหาสิ่งของที่จะขายตามวรรคหนึ่งเตรียมไว้ให้แก่ ผู้จะซื้อได้อย่างเพียงพอตามจำนวนที่คู่สัญญาได้ตกลงประมาณการไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ แต่ผู้จะซื้ออาจ สั่งซื้อจริงมากหรือน้อยกว่าจำนวนประมาณการดังกล่าวก็ได้

ข้อ ๒. การรับรองคุณภาพ

ผู้จะขายรับรองว่าสิ่งของที่จะขายให้ตามสัญญานี้ เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งาน มาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ ทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา

ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจทดลอง ผู้จะขายรับรองว่าเมื่อตรวจ ทดลองแล้วต้องมีคุณภาพไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ด้วย

ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๓.๑ รายละเอียดการจัดซื้อออกซิเจนเหลว

โรงพยาบาลกลาง สำนักงานแพทย์กรุงเทพมหานคร จำนวน ๓ หน้า

๓.๒ รายละเอียดการจัดซื้อออกซิเจนเหลว

บริษัท แอร์โปรดักส์อินดัสตรี จำกัด

จำนวน ๓ หน้า

๓.๓ แคตตาล็อก

จำนวน ๑๔ หน้า

๓.๔ ใบต่อรอง...

นางสาวสุภาพร กรลักษณ์

นางสาวรัตนันลิน พงศ์สิริภาวิน

นางสาวสุภาพร กรลักษณ์ เอกสกลชัย

ตำแหน่งงานพัสดุปฏิบัติงาน

โรงพยาบาลกลาง



(ลงชื่อ).....ผู้จะซื้อ

(ลงชื่อ).....ผู้จะขาย

๓.๔ ใบต่อรองราคา และใบเสนอราคา

จำนวน ๓ หน้า

๓.๕ รายการทั่วไป

จำนวน ๑ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้จะขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้จะซื้อ

ข้อ ๔. การออกใบสั่งซื้อแต่ละคราว

ผู้จะซื้อจะออกใบสั่งซื้อสิ่งของในแต่ละคราวเพียงรายการเดียว หรือหลายรายการพร้อมกันก็ได้ ในปริมาณแต่ละรายการตามความจำเป็นในการใช้แต่ละคราว โดยจะระบุ ปริมาณ สถานที่ และวันเวลาที่ผู้จะขายจะต้องส่งมอบไว้ในใบสั่งซื้อแต่ละคราว

ข้อ ๕. การส่งมอบ

ผู้จะขายสัญญาว่าจะส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้จะซื้อตามปริมาณ สถานที่ และวันเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งซื้อแต่ละคราวด้วยค่าใช้จ่ายของผู้จะขายเอง พร้อมทั้งหีบห่อ หรือเครื่องรัดพันผูกให้เรียบร้อย ทั้งนี้ผู้จะซื้อจะออกใบสั่งซื้อมอบให้แก่ผู้จะขายล่วงหน้าก่อนครบกำหนดเวลาส่งมอบตามใบสั่งซื้อไม่น้อยกว่า....๓....วัน

ข้อ ๖. การตรวจรับ


เมื่อผู้จะซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบ และเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา และใบสั่งซื้อในแต่ละคราวแล้ว ผู้จะซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบไว้ให้ เพื่อผู้จะขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่า สิ่งของที่ส่งมอบไม่ตรงตามสัญญาและใบสั่งซื้อ ผู้จะซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นนี้ผู้จะขายต้องรับนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ และนำสิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่ หรือเพิ่มเติมให้ถูกต้องตามสัญญาและใบสั่งซื้อด้วยค่าใช้จ่ายของผู้จะขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปดังกล่าว ผู้จะขายนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาทำการเพื่อลดหรืองดค่าปรับไม่ได้

ข้อ ๗. การชำระเงิน

ผู้จะซื้อจะชำระเงินค่าสิ่งของที่คำนวณตามปริมาณที่กำหนดในใบสั่งซื้อแต่ละคราว และตามราคาต่อหน่วยดังระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ให้แก่ผู้จะขาย ภายใน.....-.....วัน นับแต่วันที่ผู้จะขายได้แสดงหลักฐานการรับมอบตามข้อ ๖ ให้แก่ผู้จะซื้อ

/ข้อ ๘...



(ลงชื่อ).....ผู้จะซื้อ

(ลงชื่อ).....ผู้จะขาย

นางสาวกัญญา

นางสาวกัญญา เอกสกุลชัย
ตำแหน่งงานพิเศษปฏิบัติงาน
งานขาย

ข้อ ๘. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายยอมรับประกันความชำรุดบกพร่อง หรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้เป็นเวลา.....นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าวหาสิ่งของตามสัญญาเกิดชำรุดบกพร่อง หรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน - วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อ ๙. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในวันทำสัญญานี้ผู้ขายได้นำหลักประกันเป็น.....หนังสือค้ำประกันสัญญา
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเพชรเกษม ๕๑ เลขที่ ๑๐๐๐๔๘๓๔๖๔/ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
เป็นจำนวนเงิน ๑๓๒,๐๐๐.-บาท (.....หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน.....)ซึ่งเท่ากับร้อยละห้า (๕%)
ของราคาประมาณการตามข้อ ๑ มามอบไว้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ซื้อจะคืนให้เมื่อผู้ขายพ้นจาก
ข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๑๐. การบอกเลิกสัญญา

เมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ ถ้าผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขาย
ให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้
ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อจะมีสิทธิเรียกหลักประกัน หรือเรียกร้องจาก
ธนาคารผู้ออกหนังสือค้ำประกันตามสัญญา ข้อ ๙ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อ
จะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่นเพิ่มเติมจำนวน หรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่งแล้วแต่กรณี ภายใน
กำหนด ๓ เดือน นับแต่วันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ใน
สัญญานี้ด้วย

ข้อ ๑๑. ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ซื้อไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามสัญญา ข้อ ๑๐ ผู้ขายจะต้องชำระ
ค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละศูนย์จุดสองศูนย์ (๐.๒๐%) ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ
ต่อวัน นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบ ตามใบสั่งซื้อจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่
ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามใบสั่งซื้อ หรือจนถึงวันที่ผู้ซื้อได้ซื้อสิ่งของตามใบสั่งซื้อนั้นจากบุคคลอื่น
ในกรณีนี้ผู้ขายยอมรับผิดชอบใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญาด้วยซึ่งผู้ขายตกลงให้ผู้ซื้อ
หักเงินค่าปรับและราคาที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวจากราคาส่งของตามใบสั่งซื้อคราวใดก็ได้ หรือให้ผู้ซื้อเรียกร้องจาก
ผู้ขายตามสัญญา ข้อ ๑๒ หรือจะเรียกร้องจากหลักประกันสัญญาตาม ข้อ ๙ ก็ได้ ตามที่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงจะซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบ
เพียงบางส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่ายังไม่ได้ส่งมอบ
สิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาส่งของเต็มทั้งชุด

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมีได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น ถ้าผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจ
ปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกหลักประกัน หรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออก
หนังสือค้ำประกันตามสัญญา ข้อ ๙ กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในสัญญา ข้อ ๑๐ วรรคสอง
ก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งขอเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขายเมื่อครบกำหนดส่งมอบตามใบสั่งซื้อแล้ว
ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่ผู้ขายจะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย



(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย

ข้อ ๑๒
การแก้ไขข้อ

นายพนธ์ เอกสกุลชัย
ผู้อำนวยการปฏิบัติการ
แผนกบริหาร

ข้อ ๑๒. การรับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย

ถ้าผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้จะซื้อแล้ว ผู้จะขายต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้จะซื้อโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้จะซื้อ

ข้อ ๑๓. การขอขยายเวลาส่งมอบ

ในกรณีที่มิเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้จะซื้อ หรือจากพฤติการณ์อันใดอันหนึ่งซึ่งผู้จะขายไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย เป็นเหตุให้ผู้จะขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้จะขายมีสิทธิขอขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือขอลดหรืองดค่าปรับได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้จะซื้อทราบ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง

ถ้าผู้จะขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้จะขายได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำการตามสัญญาเพื่องด หรือลดค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้จะซื้อ ซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้จะซื้อทราบอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การขยายเวลาทำการตามสัญญาเพื่องด หรืองดค่าปรับตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้จะซื้อที่จะพิจารณา

ข้อ ๑๔. การใช้เรือไทย

ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้จะซื้อตามสัญญานี้ เป็นสิ่งของของผู้จะขายจะต้องสั่งหรือนำเข้ามาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้จะขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีเรือไทย หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการส่งหรือสั่งซื้อสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศเป็นแบบ เอฟ.โอ.บี. ซี.เอฟ.อาร์. ซี.ไอ.เอฟ. หรือแบบอื่นใด

ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้จะซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้จะขายจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้จะซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้จะขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้จะซื้อด้วย

ในกรณีที่ผู้จะขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในสองวรรคข้างต้นให้แก่ผู้จะซื้อ แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้จะซื้อก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าสิ่งของ ผู้จะซื้อจะมีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อนจะชำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้จะขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ผู้จะขาย...



(ลงชื่อ).....ผู้จะซื้อ

(ลงชื่อ).....ผู้จะขาย

นางเอกทิพย์

นางนันทพันธ์ เอกสกุลชัย

ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

สำนักงาน

ผู้จะขาย ต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ



(ลงชื่อ).....ผู้จะซื้อ
(นางสาวสุภาพร กรลักษณ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

(ลงชื่อ).....ผู้จะขาย
(รัตน์อิน พงศ์ศิริภาวิน)
(รัตน์อิน พงศ์ศิริภาวิน)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายธนากร สงวนสัตย์)
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง ฝ่ายบริหาร

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวนพรัตน์ พิพัฒน์เดชสุนทร)
นักวิชาการหลักสูตรบริหาร
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัสดุ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

หมายเหตุ เงินค่าสิ่งของตามสัญญานี้จะนำไปเข้าบัญชีของผู้จะขายที่ ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนมหาไชย ประเภทบัญชี กระแสรายวัน ๐๓๗-๑-๐๑๕๖๗-๑ หากผู้จะขายมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงธนาคาร และเลขที่บัญชีที่ระบุไว้ ผู้จะขายต้องแจ้งให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องทราบเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนมีการจ่ายเงิน



(ลงชื่อ).....ผู้จะซื้อ

(ลงชื่อ).....ผู้จะขาย
(รัตน์อิน พงศ์ศิริภาวิน)

นางสาวสุภาพร กรลักษณ์

นางสาวนพรัตน์ พิพัฒน์เดชสุนทร

นายธนกร สงวนสัตย์
หัวหน้างานพัสดุปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลกลาง

รายละเอียดการจัดซื้อออกซิเจนเหลว จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร

๑. ความเป็นมา

โรงพยาบาลกลางมีความจำเป็นต้องจัดซื้อออกซิเจนเหลว เพื่อใช้ในกิจการด้านการรักษาพยาบาล ซึ่งทางโรงพยาบาลไม่สามารถผลิตออกซิเจนเหลวได้เอง จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อออกซิเจนเหลวสำหรับใช้งานคิดเป็นปริมาณประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามจำนวนที่ใช้จริง กำหนดส่งของตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๖๑ หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ รายการค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุเคมี จำนวน ๒,๗๐๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) การลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายจะมีผลก็ต่อเมื่อโรงพยาบาลกลางได้รับอนุมัติเงินประจำงวดจากกรุงเทพมหานครก่อน

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อให้โรงพยาบาลกลาง มีออกซิเจนเหลวเพื่อใช้ในการด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก และใช้งานเป็นประจำอยู่ตลอดเวลา จึงจำเป็นต้องจัดซื้อออกซิเจนเหลว สำหรับใช้งานด้านการรักษาพยาบาล ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ตามจำนวนที่ใช้จริง จำนวนประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๑. ต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่จัดซื้อ
๒. ต้องไม่เป็นผู้กระทำความผิดในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้เวียนแจ้งชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้ตบบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ กรุงเทพมหานคร และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๖. เมื่อเป็นคู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
๗. เมื่อเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐแล้ว คู่สัญญาต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเคร่งครัด

สำเนาถูกต้อง

๑๐๐๐๐

๔. แบบรูป...

๑๐๐๐๐๐๐๐ เอกสกลชัย

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

โรงพยาบาลกลาง

นายสมานพันธ์ เอกสกลชัย

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

โรงพยาบาลกลาง

๑.....

(ลงชื่อ).....

ผู้จะซื้อ

(ลงชื่อ).....

ผู้จะขาย



นิติกร สำนักงานแพทย์

ตรวจให้แล้ว

๑๐๐๐๐๐๐๐

(นางสาวศศิญา วีระเดช)

นิติกร กลุ่มงานนิติกร

สำนักงานเลขานุการ สำนักงานแพทย์

๔. แบบปรายการหรือคุณลักษณะ

๑. เป็นออกซิเจนเหลวที่มีความบริสุทธิ์ และผลิตสำหรับใช้ทางการแพทย์ เพื่อให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตผู้ป่วยปราศจากการปนเปื้อน

๒. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย มีคุณลักษณะตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำหรับออกซิเจนที่ใช้ในทางการแพทย์ ตาม มอก. ๕๔๐-๒๕๔๕

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๑. โรงพยาบาลกลางมีความต้องการซื้อออกซิเจนเหลว เพื่อใช้ในการกิจการของโรงพยาบาลทั้งหมด ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาต่อหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตร และส่งของตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ตามจำนวนที่ใช้จริง จำนวนประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร โดยจะต้องนำออกซิเจนเหลวมาส่งให้โรงพยาบาลโดยเร็ว ภายใน ๒๔ ชั่วโมง นับตั้งแต่วันที่ผู้เสนอราคาได้รับการติดต่อ หากผู้เสนอราคาไม่สามารถส่งออกซิเจนเหลว ให้แก่โรงพยาบาลได้ทันตามกำหนด ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการจัดหาออกซิเจนเหลวจากแหล่งอื่นให้แก่โรงพยาบาลใช้งานไปก่อน หรือจะต้องรับผิดชอบจ่ายค่าออกซิเจนเหลวที่โรงพยาบาลกลางได้สั่งซื้อมาใช้ทดแทนทั้งสิ้น และผู้ซื้อที่มีสิทธิเรียกค่าปรับเป็นรายวันจากผู้เสนอราคา ได้ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ

๒. ผู้เสนอราคาออกซิเจนเหลวจะต้องมีโรงงานผลิตออกซิเจนเหลวไม่ต่ำกว่า ๒ โรงงาน ในที่บริเวณต่างกัน และมีกำลังการผลิตออกซิเจนเหลว โดยรวมไม่ต่ำกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ทั้งนี้หากโรงงานใดโรงงานหนึ่งเกิดชำรุด จะต้องมียกหนึ่งแห่งหนึ่งสำรองได้ รวมทั้งทำการค้าและผลิตออกซิเจนเหลวมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี เป็นสำคัญ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการขาดแคลนและความเสียหายต่อโรงพยาบาลต่อไปในอนาคต โดยผู้เสนอราคาจะต้องยื่นสำเนาหลักฐานการประกอบกิจการโรงงานผลิตออกซิเจนเหลวดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

๓. ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำหรับออกซิเจนเหลวที่ใช้ทางการแพทย์ ตาม มอก. ๕๔๐-๒๕๔๕ โดยผู้เสนอราคาจะต้องยื่นสำเนาหลักฐานแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

๔. ผู้เสนอราคาต้องมีโรงงานผลิตได้รับการรับรองระบบคุณภาพหมายความว่าโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๙๐๐๑ หรือ มอก. ๙๐๐๒ ในกิจการและขอบข่ายที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือสถาบันรับรองมาตรฐาน ไอ เอส โอ หรือ องค์การที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองระบบงาน (accreditation) โดยผู้เสนอราคาจะต้องยื่นสำเนาหลักฐานแสดงว่าเป็นโรงงานรับรองระบบคุณภาพ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง


๕. ผู้เสนอราคาออกซิเจนเหลวจะต้องมีรถขนส่งออกซิเจนเหลวไม่ต่ำกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร และจำนวนรถขนส่งไม่ต่ำกว่า ๕ คัน เป็นของผู้เสนอราคาเอง ทั้งนี้ เพื่อว่ากรณีรถคันใดคันหนึ่งชำรุด จะมีรถคันที่เหลือยังสามารถใช้ทดแทนได้ เพื่อให้มั่นใจในการจัดส่งออกซิเจนเหลวได้อย่างแน่นอน และสม่ำเสมอ อนึ่ง ผู้เสนอราคาจะต้องไม่นำรถที่ขนส่งแก๊สชนิดอื่นมาใช้สำหรับจัดส่งออกซิเจนเหลวให้กับโรงพยาบาล หากตรวจพบจะถือว่าผู้เสนอราคามีผิดสัญญา ต้องยินยอมให้โรงพยาบาลหักเงินจำนวน ๕๐,๐๐๐.-บาท ต่อครั้ง โดยผู้เสนอราคาจะต้องยื่นหลักฐานแสดงจำนวนรถขนส่งออกซิเจนเหลวมาให้โรงพยาบาลพิจารณา

ยื่นสำเนาถูกต้อง


นายสมเทพย์ เอกสกุลชัย
ผู้อำนวยการปฏิบัติการ

นายสมเทพย์ เอกสกุลชัย

ผู้อำนวยการปฏิบัติการ

๑. 

(ลงชื่อ)

๒. 

(ลงชื่อ)

Ratanalin

ผู้จะซื้อ

ผู้จะขาย



๖. ผู้เสนอ...
ต้นฉบับ...
ตรวจให้แล้ว

(นางสาวศศิมา วีระเวช)
ผู้จัดการ
สำนักงานเลขานุการ กรมการแพทย์

๖. ผู้เสนอราคาจะต้องมีประกันวินาศภัยเกี่ยวกับถังบรรจุออกซิเจนเหลว โดยมีวงเงินคุ้มครองไม่ต่ำกว่า ๕ ล้านบาทต่อเหตุการณ์ แต่ละครั้งตลอดระยะเวลาประกันภัย โดยผู้เสนอราคาจะต้องยื่นสำเนาหลักฐานการประกันวินาศภัยดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

๖. ขอบเขตของงานติดตั้ง

๑. การบริการฉุกเฉิน และซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (Preventive maintenance)

๑.๑ ผู้เสนอราคาต้องมีบริการฉุกเฉินตลอด ๒๔ ชั่วโมง

- ความต้องการออกซิเจนเหลว หรือแก๊สออกซิเจนเหลว ในกรณีฉุกเฉิน
- ความต้องการในบริการซ่อมฉุกเฉิน

๑.๒ ในกรณีที่ถังบรรจุออกซิเจนเหลวเกิดชำรุดเสียหาย เนื่องจากการใช้งานตามปกติ ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบซ่อมแซมและบำรุงรักษาให้ใช้งานได้ดีตลอดเวลา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นกับโรงพยาบาล

๑.๓ สำหรับออกซิเจนเหลวที่สูญหายไปในช่วงการขัดข้อง หรือเสียหายดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องชดเชยให้โดยไม่คิดมูลค่ากับโรงพยาบาล และในช่วงการชำรุด ถ้ามีการสูญเสียออกซิเจนไปสู่บรรยากาศจะด้วยเหตุผลประการใดก็ตาม หรือในช่วงการซ่อมทำให้จำเป็นต้องใช้แก๊สออกซิเจนจากแอมบิโพลต์ ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบชดเชยในส่วนที่เสียไปนั้น โดยไม่คิดมูลค่ากับโรงพยาบาลอีก จนกว่าการซ่อมถึงจะแล้วเสร็จ และสามารถใช้งานได้สมบูรณ์แบบ

๑.๔ การตรวจซ่อมบำรุงรักษาถังบรรจุออกซิเจนเหลว ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบบำรุงรักษาถังบรรจุออกซิเจนเหลวและอุปกรณ์ตลอดอายุสัญญา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- ทดสอบรอยรั่วของ Pipeline และวาล์วทั้งหมดทุก ๖ เดือน
- ตรวจสอบสภาพของถังบรรจุออกซิเจนเหลวและบริเวณที่ตั้งทุก ๑ ปี
- ตรวจสอบสภาพการทำงานของวาล์วนิรภัย (Pressure Relief Valve) ให้เปิดออกได้เมื่อความดันสูง (ถึงขีดกำหนด ๒๑๐ psi แล้วแต่ตำแหน่ง) ถ้าบกพร่องต้องเปลี่ยนตัวใหม่ให้ทุก ๖ เดือน
- ทดสอบ Content Indicator ให้มีความเที่ยงตรงทุก ๖ เดือน
- ทดสอบความเที่ยงตรงของ Pressure Gauge ทุก ๖ เดือน
- การตรวจสอบสภาพของ Bursing Disc ทุก ๖ เดือน
- ตรวจสอบ Pressure Raising valve ให้ปิดที่ ๑๕๕ psi ทุก ๖ เดือน

และผู้เสนอราคาจะต้องจัดส่งรายงานการตรวจสอบให้กับโรงพยาบาล ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ทำการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว และบำรุงรักษาถังออกซิเจนให้พร้อมใช้งานและส่งมอบประวัติการซ่อมบำรุงรักษาให้แก่โรงพยาบาล

๑.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องจัดให้มีการอบรมเพื่อให้ความรู้โดยวิศวกรที่มีความชำนาญเกี่ยวกับระบบแก๊สทางการแพทย์ที่ใช้ในโรงพยาบาล รวมถึงระบบความปลอดภัยต่างๆ ในการใช้แก๊ส ตามที่โรงพยาบาลกลางร้องขอ โดยผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคา

นายเนนทพันธ์ เอกสกุลชัย
ผู้อำนวยการปฏิบัติการ
โรงพยาบาลกลาง

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

นายเนนทพันธ์ เอกสกุลชัย

ผู้อำนวยการปฏิบัติการ
โรงพยาบาลกลาง

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(นางสาวศศิมา วีระเดชะ)

นิสิตกร กลุ่มงานนิสิตกร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

(นางสาวสุภาพร ภารดีคุณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง

ผู้รับผิดชอบโครงการ
โรงพยาบาลกลาง

1. ความรู้เบื้องต้น

2. วัตถุประสงค์

3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ## รายชื่อ

6. เมื่อเป็นคู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่า
 นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

7. เมื่อเป็นผู้สัญญากับหน่วยงานของรัฐแล้ว ผู้สัญญาต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและ
 ๘. ภาระการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ
 ๙. การรับจ่ายของ โครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นผู้สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554

(ลงชื่อ)..... ผู้จะขาย
(นางสาวสตีนา วิริยะ)
นิติกร กลุ่มงานนิติการ
สำนักงานเลขาธิการ สำนักงานการแพทย์

Patnalin.
คณะกรรมาธิการข้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4. แผนสรุป...
๑. อิศรา มงคลนิมิต เป็นประธานกรรมการ
๒. วิมลรัตน์ สอนพินิต เป็นกรรมการ

4. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะ

1. เป็นออกซิเจนเหลวที่มีความบริสุทธิ์ และผลิตสำหรับใช้ทางการแพทย์ เพื่อให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตผู้ป่วยปราศจากการปนเปื้อน
2. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย มีคุณลักษณะตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำหรับออกซิเจนที่ใช้ในทางการแพทย์ ตาม มอก. 540-2545

5. เงื่อนไขเฉพาะ



1. โรงพยาบาลกลางมีความต้องการซื้อออกซิเจนเหลว เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาลทั้งหมด ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาต่อหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตร และส่งของตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ตามจำนวนที่ใช้จริง จำนวนประมาณ 300,000 ลูกบาศก์เมตร โดยจะต้องนำออกซิเจนเหลวมาส่งให้โรงพยาบาลโดยเร็ว ภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาที่ผู้เสนอราคาได้รับการติดต่อ หากผู้เสนอราคาไม่สามารถส่งออกซิเจนเหลว ให้แก่โรงพยาบาลได้ทันตามกำหนด ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการจัดหาออกซิเจนเหลวจากแหล่งอื่นให้แก่โรงพยาบาลใช้งานไปก่อน หรือจะต้องรับผิดชอบจ่ายค่าออกซิเจนเหลวที่โรงพยาบาลกลางได้สั่งซื้อมาใช้ทดแทนทั้งสิ้น และผู้ซื้อมีสิทธิเรียกค่าปรับเป็นรายวันจากผู้เสนอราคา ได้ในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ

2. ผู้เสนอราคาออกซิเจนเหลวจะต้องมีโรงงานผลิตออกซิเจนเหลวไม่ต่ำกว่า 2 โรงงาน ในที่บริเวณต่างกัน และมีกำลังการผลิตออกซิเจนเหลว โดยรวมไม่ต่ำกว่า 100,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ทั้งนี้หากโรงงานใดโรงงานหนึ่งเกิดชำรุด จะต้องมียกหนึ่งแห่งสำรองได้ รวมทั้งทำการค้าและผลิตออกซิเจนเหลวมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี เป็นสำคัญ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการขาดแคลนและความเสียหายต่อโรงพยาบาลต่อไปในอนาคต โดยผู้เสนอราคาจะต้องยื่นสำเนาหลักฐานการประกอบกิจการโรงงานผลิตออกซิเจนเหลวดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

3. ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำหรับออกซิเจนเหลวที่ใช้ทางการแพทย์ ตาม มอก. 540-2545 โดยผู้เสนอราคาจะต้องยื่นสำเนาหลักฐานแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

4. ผู้เสนอราคาต้องมีโรงงานผลิตได้รับการรับรองระบบคุณภาพหมายความว่าโรงงานที่ได้รับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 9001 หรือ มอก.9002 ในกิจการและมอบภายใต้การรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือสถาบันรับรองมาตรฐาน ไอเอส โอ หรือ องค์การที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองระบบงาน (accreditation) โดยผู้เสนอราคาจะต้องยื่นสำเนาหลักฐานแสดงสำเนาถูกต้องเป็นโรงงานรับรองระบบคุณภาพ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

5. ผู้เสนอราคาออกซิเจนเหลวจะต้องมีรถขนส่งออกซิเจนเหลว ไม่ต่ำกว่า 8,000 ลิตร และยานยนต์อื่น ๆ อีกไม่น้อยกว่า 5 คัน เป็นของผู้เสนอราคาเอง ทั้งนี้ เพื่อว่าการถดถอยใดคันหนึ่งชำรุด จะมีรถคันที่เหลื้อยู่ยังสามารถใช้ทดแทนได้ เพื่อให้มั่นใจในการจัดส่งออกซิเจนเหลวได้อย่างแน่นอน และสม่ำเสมอ อนึ่ง ผู้เสนอราคาจะต้องไม่นำรถที่ขนส่งแก๊สชนิดอื่นมาใช้สำหรับจัดส่งออกซิเจนเหลวให้กับโรงพยาบาล หากตรวจสอบพบจะถือว่าผู้เสนอราคาคิดผิดสัญญา ต้องยินยอมให้โรงพยาบาลคิดค่าปรับ จำนวน 50,000.-บาท ต่อครั้ง โดยผู้เสนอราคาจะต้องยื่นหลักฐานแสดงจำนวนรถขนส่งออกซิเจนเหลวมาให้โรงพยาบาลพิจารณา

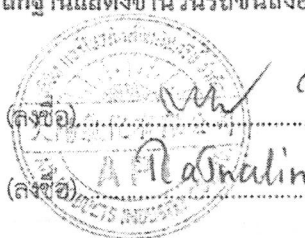

6. ผู้เสนอ...
ผู้ซื้อ...
ผู้ขาย...
วันที่...
สถานที่...

6. ผู้เสนอราคาจะต้องมีประกันวินาศภัยเกี่ยวกับถังบรรจุออกซิเจนเหลว โดยมีวงเงินคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 5 ล้านบาทต่อเหตุการณ์ แต่ละครั้งตลอดระยะเวลาประกันภัย โดยผู้เสนอราคาจะต้องยื่นสำเนาหลักฐานการประกันวินาศภัยดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

6. ขอบเขตของงานติดตั้ง

1. การบริการฉุกเฉิน และซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (Preventive maintenance)

1.1 ผู้เสนอราคาต้องมีบริการฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง

- ความต้องการออกซิเจนเหลว หรือแก๊สออกซิเจนเหลว ในกรณีฉุกเฉิน
- ความต้องการในบริการซ่อมฉุกเฉิน

1.2 ในกรณีที่ถังบรรจุออกซิเจนเหลวเกิดชำรุดเสียหาย เนื่องจากการใช้งานตามปกติ ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบซ่อมแซมและบำรุงรักษาให้ใช้งานได้ดีตลอดเวลา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นกับโรงพยาบาล

1.3 สำหรับออกซิเจนเหลวที่สูญหายไปในช่วงการขัดข้อง หรือเสียหายดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องชดเชยให้โดยไม่คิดมูลค่ากับโรงพยาบาล และในช่วงการชำรุด ถ้ามีการสูญเสียออกซิเจนไปสู่บรรยากาศจะด้วยเหตุผลประการใดก็ตาม หรือในช่วงการซ่อมทำให้จำเป็นต้องใช้แก๊สออกซิเจนจากแมนนิโฟลด์ ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบชดเชยในส่วนที่เสียไปนั้น โดยไม่คิดมูลค่ากับโรงพยาบาลอีก จนกว่าการซ่อมจะแล้วเสร็จ และสามารถใช้งานได้สมบูรณ์แบบ

1.4 การตรวจสอบบำรุงรักษาดังบรรจุออกซิเจนเหลว ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบ

การบำรุงรักษาดังบรรจุออกซิเจนเหลวและอุปกรณ์ตลอดอายุสัญญา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

Amn
นางพนทิพย์ เอกสกุลชัย
หัวหน้างานปฏิบัติการ
โรงพยาบาล

- ทดสอบรอยรั่วของ Pipeline และวาล์วทั้งหมดทุก 6 เดือน
- ตรวจสอบสภาพของถังบรรจุออกซิเจนเหลวและบริเวณที่ตั้งทุก 1 ปี
- ตรวจสอบสภาพการทำงานของวาล์วนิรภัย (Pressure Relief Valve) ให้เปิดออกได้

เมื่อความดันสูง (ถึงขีดกำหนด 210 psi แล้วแต่ตำแหน่ง) ถ้าบกพร่องต้องเปลี่ยนตัวใหม่ให้ทุก 6 เดือน

ท่านาญกต

- ทดสอบ Content Indicator ให้มีความเที่ยงตรงทุก 6 เดือน

นางกร สำนักรแพทย์
ตรวจให้แล้ว

Worut

- ทดสอบความเที่ยงตรงของ Pressure Gauge ทุก 6 เดือน

นางพนทิพย์ เอกสกุลชัย
หัวหน้างานปฏิบัติการ
โรงพยาบาล

- การตรวจสอบสภาพของ Bursing Disc ทุก 6 เดือน

(นางสาวศศิภา นิลเกษ)

- ตรวจสอบ Pressure Raising valve ให้ปีที่ 155 psi ทุก 6 เดือน

นิสิกร กรุงเทพมหานคร
นางสาวณัฏฐพร นำนักรแพทย์

และผู้เสนอราคาจะต้องจัดส่งรายงานการตรวจสอบให้กับโรงพยาบาล ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ทำการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว และบำรุงรักษาดังออกซิเจนให้พร้อมใช้งานและส่งมอบประวัติการซ่อมบำรุงรักษาให้แก่โรงพยาบาล

1.5 ผู้เสนอราคาจะต้องจัดให้มีการอบรมเพื่อให้ความรู้โดยวิศวกรที่มีความชำนาญเกี่ยวกับระบบแก๊สทางการแพทย์ที่ใช้ในโรงพยาบาล รวมถึงระบบความปลอดภัยต่างๆ ในการใช้แก๊ส ตามที่โรงพยาบาลกลางร้องขอ โดยผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายทั้งหมด

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

ผู้จะซื้อ

ผู้จะซื้อ

Rasnaln


นายกรแพทย์โรงพยาบาล

นางสาวณัฏฐพร นำนักรแพทย์

นางสาวศศิภา นิลเกษ

นางสาวณัฏฐพร นำนักรแพทย์

Air Products Industry API

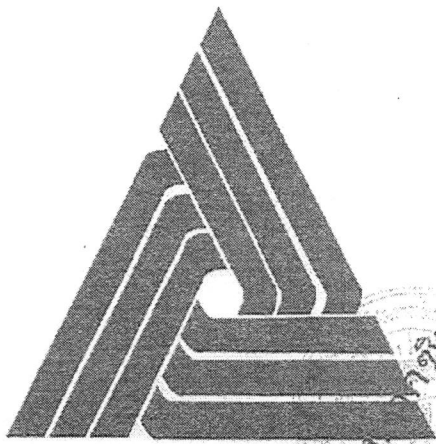

A member of TNSC group

สำนักงานลูกค้า

Asst. Mr.
นาย นพพันธ์ เอกสกุลชัย
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
โรงพยาบาลกลาง

สำนักงานลูกค้า

Asst. Mr.
นาย นพพันธ์ เอกสกุลชัย
หัวหน้างานปฏิบัติการ
โรงพยาบาลกลาง

นิติกร สำนักงานแพทย์
ตรวจให้แล้ว

ศิริพร
(นางสาวศศิณา วีระเดช)
นิติกร กลุ่มงานนิติกร
สำนักงานเลขาธิการ สำนักงานแพทย์




TAIYO NIPPON SANSO
The Gas Professionals

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

Asst. Mr.
Rasnatin

คณะกรรมการซื้อโดยวิธีเลือกผู้จำหน่าย
๑. *ศิริพร* *ทพ.นพ.* ประธานกรรมการ
๒. *ศิริพร* *ศิริพร* กรรมการ
๓. *TH* กรรมการ
ผู้จะขาย



Company Profile

1. Address: 282 Bang Bon 3 Road, Kwaeng Nongkaem, Khet Nongkaem, Bangkok 10160
2. Establishment: September 1977
3. Fields of Business: Production and sales of industrial gases
4. Registered Capital: 132,000,000 baht
5. Shareholders: Taiyo Nippon Sanso Corporation, Japan 97%
Thai shareholders 3%
6. Major Plant Locations: Bangpa-in (Ayutthaya), Bangpakong (Chonburi), Lamphun, etc.
7. Number of Employees: 280
8. Associate Companies: PSA Chemtech Co., Ltd.



สำเนาถูกต้อง

RaSnalin.

สำเนาถูกต้อง

Wantri

สำเนาถูกต้อง

นางวันทพันธ์ เอกสกุลชัย
ผู้อำนวยการปฏิบัติการ
โรงพยาบาลกลาง

นางวันทพันธ์ เอกสกุลชัย
ผู้อำนวยการปฏิบัติการ
โรงพยาบาลกลาง

นิติกร สำนักงานแพทย์
ตรวจให้แล้ว

(นางสาวคตินา วีระเดช)

นิติกร กลุ่มงานจัดการ
สำนักงานเลขานุการ สำนักงานแพทย์

คณะกรรมการซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑. ชื่อ ประสานกรรมการ
๒. พึงพอใจ กรรมการ
๓. กรรมการ

(ลงชื่อ) ผู้จะซื้อ

(ลงชื่อ) RaSnalin. ผู้จะขาย



Company Milestone

- 1977 Establishment of API
- 1979 Started air separation plant (Bangkok) No.1
- 1981 Started air separation plant (Bangkok) No.2
- 1987 Started air separation plant (Bangkok) No.3
- 1992 Started on-site oxygen PSA (Phra Pradeang)
- 1993 Started air separation plant (Bangpa-in 1) & nitrogen pipeline
- 1997 Started air separation plant (Lamphun 1) & nitrogen pipeline
- 1999 Started on-site oxygen PSA & ASP (Nongmon, Chonburi)
- 1999 Started air separation plant (Bangpa-in 2)
- 2001 Started nitrogen generator (Lamphun 2)
- 2001 Received ISO 9001:2000 from MASCI
- 2002 Started nitrogen generator (Navanakorn 1)
- 2002 Started air separation plant (Lamphun 3)
- 2004 Started air separation plant (Bangpakong)
- 2005 Started on-site oxygen PSA (Nongmon, Chonburi)
- 2006 Started nitrogen generator (Lamphun 4)
- 2006 Started nitrogen generator (Navanakorn 2)
- 2009 Started nitrogen generator & liquifier (Lamphun 5)

นายณนทพันธ์ เอกสกุลชัย


เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โรงพยาบาลกลาง

๑. อรรถ ประธานกรรมการ
๒. พิเชษฐ สอ ทศ พิ กรรมการ
๓. (ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) Ratnalin. ผู้จะขาย

นิติกร สำนักงานเขต
ตรวจให้แล้ว


(นางสาวกัญญา)
นิติกร สำนักงานเขต
เลือกสรร สำนักงานเขต





Fields of Business

- Supply of bulk liquid industrial gases:
liquid oxygen (LOX), nitrogen (LIN), argon (LAR)
- Gas supply by on-site & pipeline:
gaseous nitrogen & oxygen
- Cylinder gas supply:
oxygen, nitrogen, argon, hydrogen, helium
standard gases, mixed gases, etc.
- Gas related equipment & facility

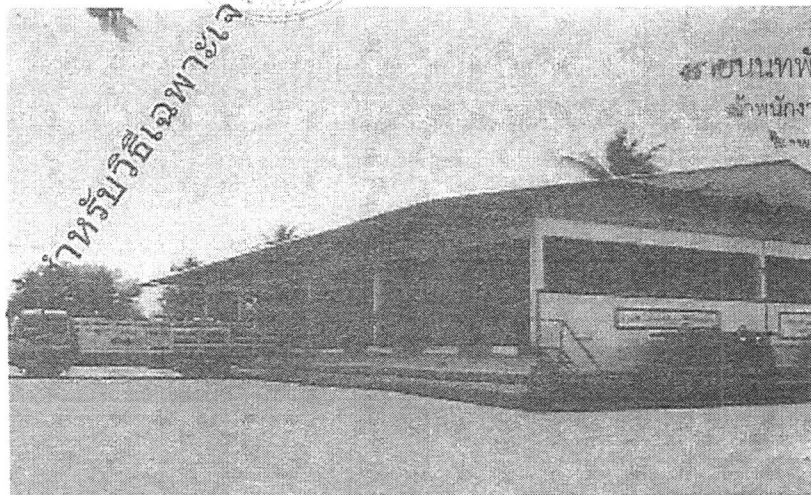


สำนักงาน
นายพนนพันธ์ เอกสกุลชัย
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลกลาง

คณะกรรมการซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๑. ...
๒. ...
๓. ...

(ลงชื่อ) ...

นิติกร สำนักงานการแพทย์
ตรวจให้แล้ว



Production



● Overall Capacity

LOX	6,200 m3/h
LIN	17,000 m3/h
LAR	240 m3/h

ถ้าเมื่อก่อน
Platnalin.

Bangpakong Plant in Amatanakorn I.E., Chonburi
started operation in May 2004

Selected by Ministry of Industry as
Best 999 Factories in 2006

นายสมพงษ์ เอกสกุลชัย
ผู้อำนวยการปฏิบัติการ
โรงงานกลั่น

นายสมพงษ์ เอกสกุลชัย
ผู้อำนวยการปฏิบัติการ
โรงงานกลั่น


นิติกร สำนักงานแพทย์
ตรวจให้แล้ว

(นางสาวศศิมา วีระเกษะ)
นิติกร กลุ่มงานนิติกร
สำนักงานเลขาธิการ สำนักงานแพทย์


- คณะกรรมการข้อบัญญัติเฉพาะเจาะจง
1. นายสมพงษ์ เอกสกุลชัย ประธานกรรมการ
 2. นายสมพงษ์ เอกสกุลชัย กรรมการ
 3. นายสมพงษ์ เอกสกุลชัย กรรมการ

(ลงชื่อ).....ผู้จะซื้อ


(ลงชื่อ) Platnalin.....ผู้จะขาย



Inventory

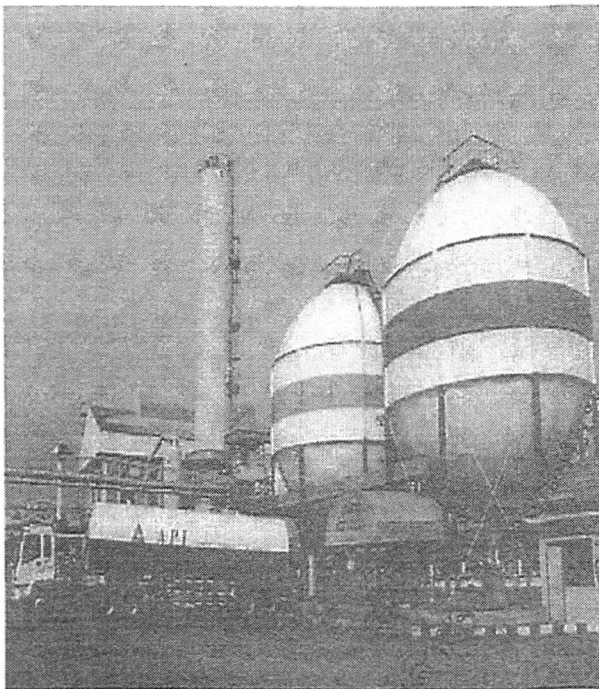

Bangpa-in, Ayutthaya

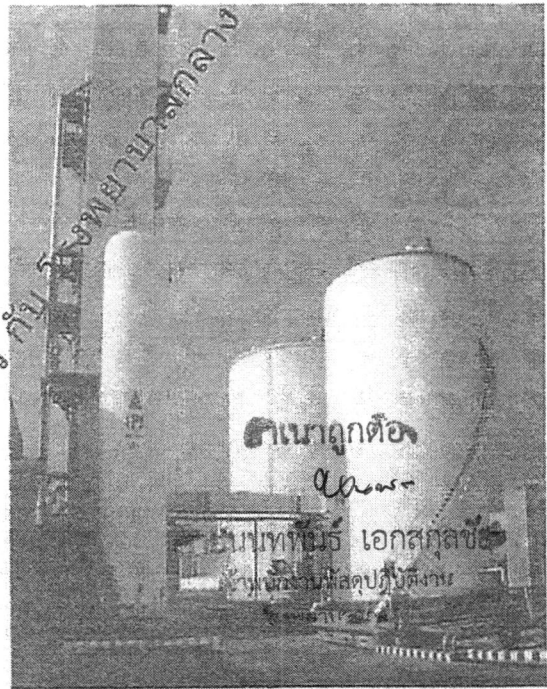

สถานีแก่งคอย

Bangpakong, Chonburi

สถานีแก่งคอย

Wentus
นายพนทพันธ์ เอกสกุลชัย
เจ้าหน้าที่ควบคุมปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลกลาง

LOX
LIN
LAR

2,040 tons
2,800 tons
285 tons

Overall Capacity

นิติกร สำนักการแพทย์
ตรวจให้แล้ว

(นางสาวศศิมา ชีวเดชะ)
นิติกร กลุ่มงานนิติกร
สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์

คณะกรรมการซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑. ประธานกรรมการ
๒. กรรมการ
๓. (ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

ผู้จะซื้อ


ผู้จะขาย



Distribution

● Number of tank lorries & trailers

product	number
LOX	29
LIN	32
LAR	4

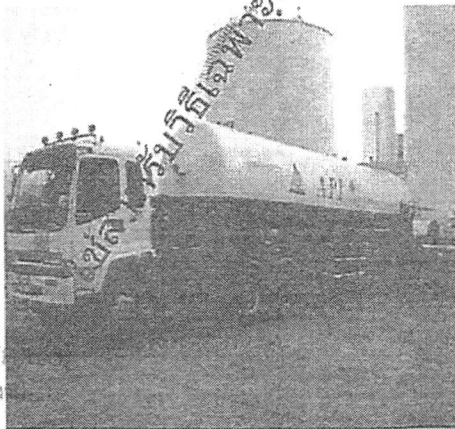

เช่ามาถูกต้อง

นายแพทย์

นายแพทย์พันธ์ เอกส
เจ้าพนักงานพิสูจน์
โรงพยาบาล

เช่ามาถูกต้อง

นายแพทย์

นายแพทย์พันธ์ เอกสกุลชัย

เจ้าพนักงานพิสูจน์ปฏิบัติงาน

โรงพยาบาล

คณะกรรมการใช้โลโก้

๑. นายแพทย์

๒. นายแพทย์

๓. นายแพทย์

(ลงชื่อ).....


(ลงชื่อ).....


นิติกร สำนักการแพทย์

ตรวจให้แล้ว

ผู้ซื้อจาก

ผู้จำหน่าย



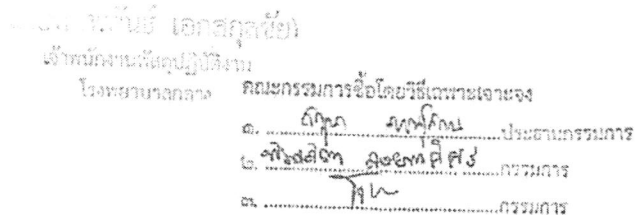

นิติกร สำนักการแพทย์
ตรวจให้แล้ว

(นางสาวศศิญา วัฒนพงษ์)

SECRET

เจ้าพนักงานเลขานุการ: สำเนาถวายแด่
พระเจ้าอยู่หัว

大陽文化有限

ผู้กระจาย



Product Specifications

Product	Purity	Analyzing Methods
Liquid Oxygen	> Oxygen Purity 99.5 % > Dew Point - 68 °C	Paramagnetic Method Dew Point Meter
Liquid Nitrogen	> Nitrogen Purity 99.999 % > Oxygen less than 5 ppm > Dew Point - 68 °C	Electro Chemical Analyzer Dew Point Meter
Liquid Argon	> Argon Purity 99.999 % > Oxygen less than 5 ppm > Dew Point - 68 °C	Electro Chemical Analyzer Dew Point Meter
Gaseous Hydrogen	> Hydrogen Purity 99.8 % > Oxygen less than 15 ppm > Dew Point - 60 °C	Thermal Conductivity Method Electro Chemical Analyzer Dew Point Meter

นายพนธ์ เอกสกุลชัย
 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
 โรงพยาบาลกลาง


คณะกรรมการซื้อโดยโรงพยาบาล

๑. ...
 ๒. ...
 ๓. ...

(ลงชื่อ) ...
 (ลงชื่อ) ...

นิติกร สำนักงานแพทย์
 ตรวจให้แล้ว

(ลงชื่อ) ...
 (ลงชื่อ) ...



Product Specifications

Standard specifications of products

Product (Grade)	Component	Industrial (Commercial)	High Purity (H.P.)	Ultra High Purity (U.H.P.)
Oxygen	Purity	99.5 %	99.8 %	99.99%
	Dew Point	- 68 °C	- 80 °C	- 80 °C
Nitrogen	Purity	99.99%	99.995%	99.999%
	Oxygen Content	< 10 ppm	< 5 ppm	< 3 ppm
	Dew Point	- 68 °C	- 68 °C	- 70 °C
Argon	Purity	99.99%	99.995%	99.999%
	Oxygen Content	< 10 ppm	< 5 ppm	< 3 ppm
	Dew Point	- 65 °C	- 68 °C	- 70 °C
Hydrogen	Purity	99.8%	99.99%	99.999%
	Oxygen Content	< 15 ppm	< 5 ppm	< 3 ppm
	Dew Point	- 60 °C	- 68 °C	- 70 °C
Helium	Purity	99.0%	99.99%	99.999%
	Oxygen Content	-	< 10 ppm	< 3 ppm
	Dew Point	- 60 °C	- 65 °C	- 68 °C
CO2	Purity	99.9 %	99.99%	
Air Zero	Oxygen Content	21.0 %		
	Nitrogen Content	79.0 %		

นายแพทย์พันธ์ เอกสกุลชัย

ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

โรงพยาบาลกลาง

1. คุณ ภาณุวัฒน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

2. คุณ อนุชิต ตำแหน่ง ผู้จัดการ

3. คุณ (ลงชื่อ) ตำแหน่ง กรรมการ

(ลงชื่อ)

Platinahin

นิติกร สำนักงานแพทย์


ตรวจให้แล้ว

ผู้จะชื่อ

(นางสาวศศิธร วิสุทธร)

ผู้จะชื่อย่อ นางสาวศศิธร วิสุทธร

สำนักงานเลขานุการ



Weight and Volume Equivalence

WEIGHT AND VOLUME EQUIVALENCE

	Wt. of Liquid or Gas kg.	Vol. of Liquid at Normal Boiling Point °C	Vol. of Gas at 760 mm Hg 27 Degree C m ³
OXYGEN	1.000	0.876	0.769
	1.141	1.000	0.877
	1.300	1.000	1.000
NITROGEN	1.000	1.237	0.879
	1.009	1.000	0.710
	1.137	1.408	1.000
ARGON	1.000	0.717	0.616
	1.394	1.000	0.859
	1.623	1.164	1.000
HYDROGEN	1.000	14.125	1.000
	0.071	1.000	0.866
	0.082	1.155	1.000

น้ำหนักต้อง

ของเหลว

นายแพทย์พันธ์ เอกสกุลชัย

ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

โรงพยาบาล

๑. ประธานกรรมการ

๒. กรรมการ

๓. กรรมการ

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

นิติกร สำนักการแพทย์

ตรวจได้

ผู้จะซื้อ

(นางสาวศิริณี ทรัพย์สมบูรณ์)

ผู้จะขาย

สำนักงานเภสัชกรรม



Safety Distance for Oxygen Storage Tank


ระยะความปลอดภัยของสถานที่ติดตั้งบรรจุออกซิเจนเหลว
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ออกซิเจน การแพทย์ (มอก 540-2555)

ประเภทวัตถุ	ระยะห่างจากถังเก็บออกซิเจนเหลว เมตร	
	ขนาดไม่เกิน 20 ตัน	ขนาดเกิน 20 ตันถึง 200 ตัน
เปลวไฟ ครุ่นไฟ	5	8
แหล่งเก็บวัสดุติดไฟ บ้านไม้	5	8
ปล่องระบายก๊าซเชื้อเพลิง	5	8
ห้องเครื่องหัวใบ (ยกเว้นรถที่ไดรฟ์แบบยก)	5	8
ถนนสาธารณะ	5	8
รางรถไฟ	10	15
รั้วโรงพยาบาล	5	8
สำนักงาน ห้องอาหาร ที่คนอยู่รวมกัน	5	8
ชุมชนสาธารณะ เช่น สนามกีฬา	10	15
ท่อก๊าซหรือของเหลวติดไฟได้ (ไม่มีข้อต่อหัวอื่น)	3	3
เครื่องยนต์ เครื่องจักรที่ไม่เกี่ยวข้องกับออกซิเจน	5	5

ใช้สำหรับรั้วเหล็ก

เจ้าหน้าที่

นายแพทย์พันธ์ เอกสกุลชัย
ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ
โรงพยาบาลกลาง

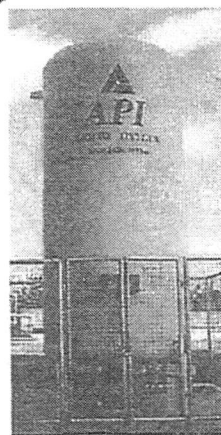

คณะกรรมการโลจิสติกส์เฉพาะของ

๑. ศิริก ภูมิโนะ ประธานกรรมการ

๒. พงศกร ทรัพย์พิรุณ กรรมการ

๓. ... กรรมการ

(ลงชื่อ) ... ผู้จะซื้อ
(ลงชื่อ) ... ผู้จะขาย

นายแพทย์พันธ์ เอกสกุลชัย

ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ

โรงพยาบาลกลาง

นิติกร สำนักงานแพทย์
ตรวจให้แล้ว


...

(นางสาวศศิณา วีระชนะ)

นิติกร กลุ่มงานนิติการ

สำนักงานเลขานุการ สำนักงานแพทย์





โรงพยาบาลกลาง เท่านั้น

Air Products Industry Co., Ltd.



สำเนาถูกต้อง
Ratnalin.

Thank you

ใช้สำหรับวิธีเฉพาะเจาะจง

สำเนาถูกต้อง

Wan

นายพนธ์ เอกสกุลชัย

ผู้อำนวยการปฏิบัติการ

โรงพยาบาลกลาง

นิติกร สำนักการแพทย์
ตรวจให้แล้ว

สสพ

สำเนาถูกต้อง

Wan

นายพนธ์ เอกสกุลชัย

ผู้อำนวยการปฏิบัติการ
โรงพยาบาลกลาง

คณะกรรมการซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑. สัญญา วิธีเฉพาะเจาะจง ประเภทโครงการ

๒. สัญญา วิธีเฉพาะเจาะจง ประเภทโครงการ

๓. สัญญา วิธีเฉพาะเจาะจง ประเภทโครงการ

(นางสาวศศิมา วีระชนะ)

นิติกร กลุ่มงานนิติกร

สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์

(ลงชื่อ).....ผู้จะซื้อ

(ลงชื่อ).....ผู้จะขาย

Ratnalin.



ใบต่อรองราคา

ถึง ผู้จัดการ บริษัท เบลูไพลัส จำกัด

ตามที่ท่านได้เสนอ นายฉลภรณ์ เบลู 300,000 บาท

กับโรงพยาบาลกลาง เป็นเงิน 2,640,000.- บาท (สองล้านหกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ในการนี้ขอให้ท่านลดราคาลงให้ต่ำกว่าราคาที่เสนอมา
และโปรดยื่นยื่นไปที่ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลกลาง

ลงชื่อ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑. ศักดา หนูโกล
๒. จิรสง่า สอนพัสร์
๓. 

เรียน คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ตามที่ได้ออกราคานั้น บริษัท ขอยื่นยื่นบทบาทที่เสนอ เป็นจ้ด
ยื่นทั้งสิ้น 2,640,000.00 บาท (สองล้านหกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

ราคาสุทธิ


ราคาสินค้า 2,467,289.72 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 172,710.28 บาท
ราคารวม 2,640,000.00 บาท


นายเนตพันธ์ เอกสกุลชัย
ผู้อำนวยการพัสดุปฏิบัติงาน
โรงพยาบาล

สำเนาถูกต้อง


นายเนตพันธ์ เอกสกุลชัย
ผู้อำนวยการพัสดุปฏิบัติงาน
โรงพยาบาล





ลงชื่อ 
(.....รัตนันดิน พงศ์ศิริภาวิน.....)
(ประทับตราลาย)


ลงชื่อ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปลัดกร สำนักการแพทย์
ตรวจให้แล้ว

๑. ศักดา หนูโกล
๒. จิรสง่า สอนพัสร์
๓. 

(ลงชื่อ)  ผู้จะซื้อ

(ลงชื่อ)  ผู้จะขาย



ใบเสนอราคา

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง (ผ่านคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

1. ข้าพเจ้า บริษัท แอร์โปรคักส์อินดัสตริย์ จำกัด (ชื่อบริษัท ห้าง ร้าน ผู้เสนอราคา)
 อยู่เลขที่ 282 ถนน บางนอน 3 ตำบล/แขวง หนองแขม
 อำเภอ/เขต หนองแขม จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-4455010
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105520014093 โดย นางสาวรัตนันลิน พงศ์ศิริภาวิน
 ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้ง
 รับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการ
2. ข้าพเจ้าเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ ซึ่งกำหนดไว้ในเอกสารสอบราคา ตามราคา
 และกำหนดเวลาส่งมอบดังต่อไปนี้


ที่	รายการ	ราคา ต่อหน่วย (ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม)	ภาษี มูลค่า เพิ่ม (ต่อหน่วย)	จำนวน	รวมเป็นเงิน	กำหนด ส่งมอบ
1	จัดซื้อออกซิเจน เหลว	8.23 บาท	0.57 บาท	300,000 ลูกบาศก์เมตร	2,640,000.00 บาท	ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2561

ถ้าเนาถูกต้อง

นายพนธ์ เอกสกุลชัย
 หัวหน้างานทดสอบปฏิบัติงาน
 โรงพยาบาลกลาง

ราคาสินค้า	2,467,289.72
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	172,710.28
รวมราคาทั้งสิ้น	2,640,000.00

(สองล้านหกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมทั้งอากรอื่น และทำให้จ่ายทั้ง
 นิตกร สำนักงานการแพทย์
 ครบถ้วนแล้ว



นางสาวกนิษฐา วีระเดชะ
 นิตกร กลุ่มงานนิตกร 1-2-
 สำนักงานเลขานุการ สำนักงานการแพทย์

(ลงชื่อ) ผู้จะซื้อ
 (ลงชื่อ) Ratanalin ผู้จะขาย

คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 ๑. ประธานกรรมการ
 ๒. กรรมการ
 ๓. กรรมการ

3. คำเสนอนี้จะยื่นอยู่เป็นระยะเวลา.....365.....วัน นับแต่วันเปิดซองเสนอราคาแลกรุงเทพมหานครอาจ
รับคำเสนออื่น ณ เวลาใดก็ได้ ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยึดออกไปตาม
เหตุผลอันสมควรที่กรุงเทพมหานครร้องขอ

4. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

4.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญากับกรุงเทพมหานครภายใน.....7.....วัน นับถัดจากวัน
ที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

4.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาให้หัวหน้าหน่วยงาน ก่อนหรือในขณะที่ได้
ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ.....5.....ของราคาตามสัญญาที่ได้รับไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็น
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายินดีชดใช้ค่าเสียหายใดที่
อาจมีแก่กรุงเทพมหานคร และกรุงเทพมหานครมีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคาอื่นเป็นผู้เสนอราคาได้หรือ
กรุงเทพมหานครอาจเรียกเสนอราคาใหม่ก็ได้

5. ข้าพเจ้ายอมรับว่ากรุงเทพมหานครไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนออื่น หรือใบเสนอราคาใด ๆ
รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

6. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง (Sample) แคตตาล็อก แบบรูป รายละเอียด
คุณลักษณะ (Specifications) ซึ่งข้าพเจ้าได้ส่งให้แก่กรุงเทพมหานครพร้อมใบเสนอราคา ข้าพเจ้ายินยอมให้
กรุงเทพมหานครใช้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของทางราชการ

สำหรับตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานคืนให้ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหาย
ใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวอย่างนั้น

7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดย
ละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่ากรุงเทพมหานครไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

8. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลล่อหลอหรือการฉ้อโกง
โดยไม่ขัดแย้งกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัท ใด ๆ ที่ได้ยื่น
เสนอราคาในคราวเดียวกัน

ธนพนธ์ เอกสกุลชัย

ข้าพเจ้าพนักงานปฏิบัติการ

ท่านาถูกต้อง

เสนอมา ณ วันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ธนพนธ์ เอกสกุลชัย
ข้าพเจ้าพนักงานปฏิบัติการ
โรงพยาบาลกลาง



(ลงชื่อ)

Radnalin.

(นางสาวรัตนันลิน พงศ์ศิริภาวิน)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด

ประทับตรา (ถ้ามี)

คณะกรรมการอำนวยการ

๑. รองอธิบดี

๒. รองอธิบดี

๓. รองอธิบดี

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

ผู้จะซื้อ

ผู้จะขาย

ผู้จะขาย

นิติกร สำนักงานแพทย์
ตรวจให้แล้ว

(นางสาวศศิญา วีระเดชะ)
นิติกร กลุ่มงานนิติกร
สำนักงานเลขานุการ สำนักงานแพทย์


รายการทั่วไป

ในกรณีผู้จะขายมีความประสงค์จะขอต่ออายุสัญญา หรือขออุทธรณ์การต่ออายุสัญญา ให้ยื่นคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษร แสดงเหตุผลแห่งการนั้น พร้อมทั้งหลักฐานต่างๆ (ถ้ามี) โดยยื่นที่กองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ภายในระยะเวลาดังนี้

๑. การขอต่ออายุสัญญาให้ยื่นคำร้องต่อผู้จะซื้อก่อนสิ้นอายุสัญญาหรืออย่างช้าไม่เกิน ๑๕ วัน นับแต่วันสิ้นสุดอายุสัญญา

๒. การขออุทธรณ์การต่ออายุสัญญา ให้ยื่นคำร้องต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายในเวลาไม่เกิน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้ทราบผลการพิจารณาต่ออายุสัญญา

การยื่นคำร้องขอต่ออายุสัญญา หรือขออุทธรณ์การต่ออายุสัญญาที่ยื่นเกินกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้จะขายสละสิทธิในการต่ออายุสัญญา



(ลงชื่อ).....ผู้จะซื้อ

(ลงชื่อ).....ผู้จะขาย

ตำแหน่งผู้ต้อง

.....

.....

.....

.....

นิติกร สำนักการแพทย์
ตรวจให้แล้ว

.....

(นางสาวศศิมา วีระเดชะ)

นิติกร กลุ่มงานนิติการ

สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์

ตำแหน่งผู้ต้อง

.....

.....

.....